

# CERTIFICADO DE ANÁLISE



**Teste em cubetas:** Fósforo total Cód. UP141  
**Faixa de leitura:** 0,15 – 2,0 mg P-PO<sub>4</sub><sup>3-</sup>/L  
**Lote:** 141014  
**Validade:** 04/2017

**Data da calibração:** 02/12/2015

**Técnico responsável:** Joana Sartoretto Leão

**Equipamento:** DR2800

**Comprimento de onda:** 850 nm

**Substância padrão:** ácido fosfórico

**Varição permitida:** ±10 % para os espectrofotômetros Hach, modelos DR2800, DR3900, DR 5000 e DR 6000


**Calibração espectrofotômetros Hach:**  $C = a + b \cdot A$

$$a = - 0,2531$$

$$b = 2,4795$$

$$R^2 = 0,9956$$

$$R = 0,9978$$

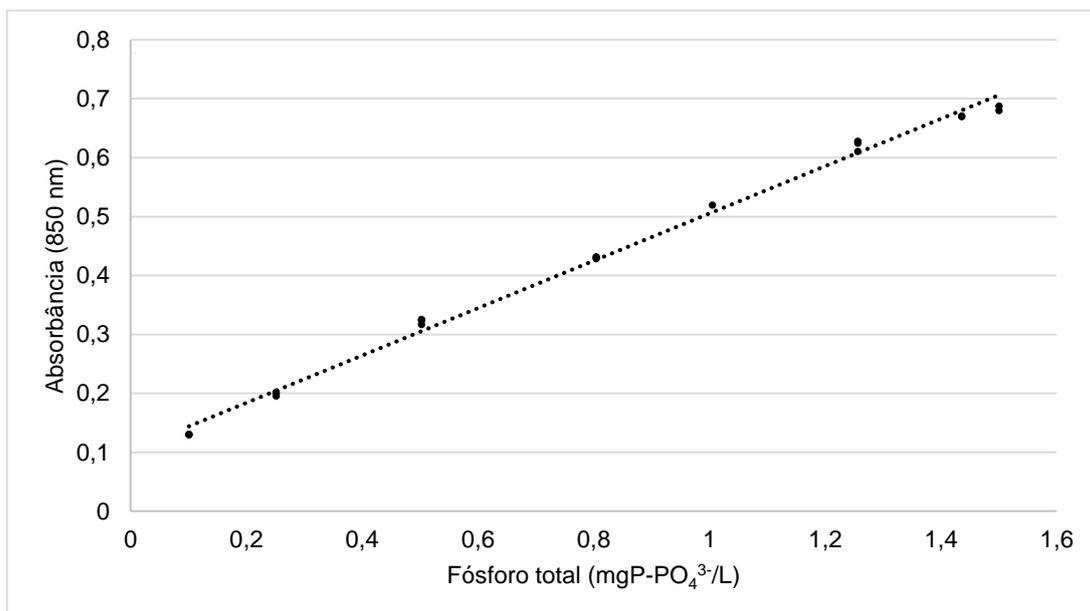

*Joana Sartoretto Leão*

Técnico responsável