

## CERTIFICADO DE ANÁLISE

**Teste em cubetas:** DQO Cód. UP112  
**Faixa de leitura:** 100 – 2000 mgO<sub>2</sub>/L  
**Lote:** 112029  
**Validade:** 01/2018

**Data da calibração:** 25/11/2016

**Técnico responsável:** Joana Sartoretto Leão

**Equipamento:** DR3900

**Comprimento de onda:** 605 nm

**Substância padrão:** hidrogenoftalato de potássio



**Variação permitida:** ±5 % para os espectrofotômetros Hach, modelos DR2800, DR3900, DR 5000 e DR 6000

**Calibração espectrofotômetros Hach:** C = a + b\*A

$$a = -105,945$$

$$b = 2080,289$$

$$R^2 = 0,9997$$

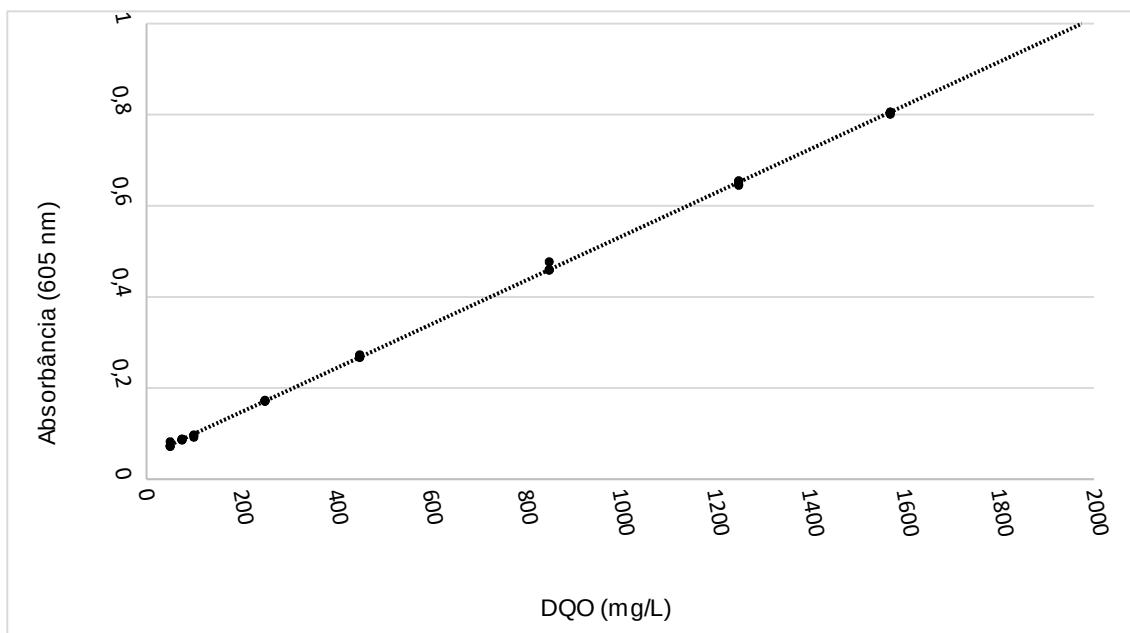

Técnico responsável