

CERTIFICADO DE ANÁLISE



Teste em cubetas: Ortofosfato Cód. UP143
Faixa de leitura: 0,1 – 4,5 mg PO₄³⁻/L
Lote: 143006
Validade: 08/2018

Técnico responsável pela calibração: Joana Sartoretto Leão

Equipamento utilizado pela calibração: espectrofotômetro da marca Hach, modelo DR3900

Comprimento de onda: 850 nm


Substância padrão: ácido fosfórico


Fórmula: $C = a + b \cdot A$

a = - 0,7008

b = 6,5755

R² = 0,9998

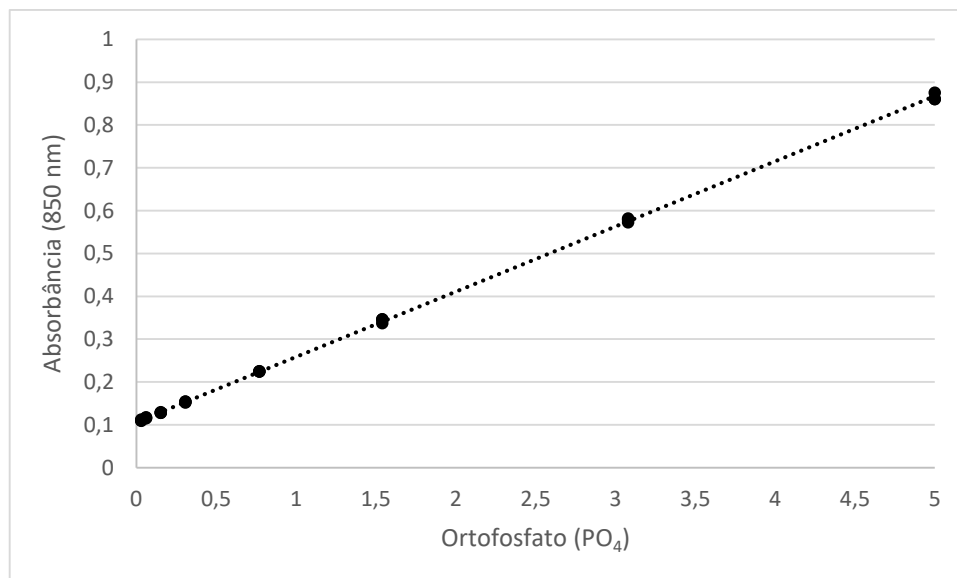

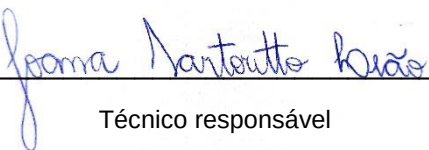
Técnico responsável