

CERTIFICADO DE ANÁLISE



Teste em cubetas: Fósforo total Cód. UP141
Faixa de leitura: 0,1 – 1,5 mg P-PO₄/L
Lote: 141023
Validade: 02/2018

Data da calibração: 03/03/2017

Técnico responsável: Joana Sartoretto Leão

Equipamento: DR3900

Comprimento de onda: 850 nm

Substância padrão: ácido fosfórico


Varição permitida: ±5 % para os espectrofotômetros Hach, modelos DR2800, DR3900, DR 5000 e DR 6000


Calibração espectrofotômetros Hach: $C = a + b \cdot A$

a = - 0,258

b = 2,0802

R² = 0,9986

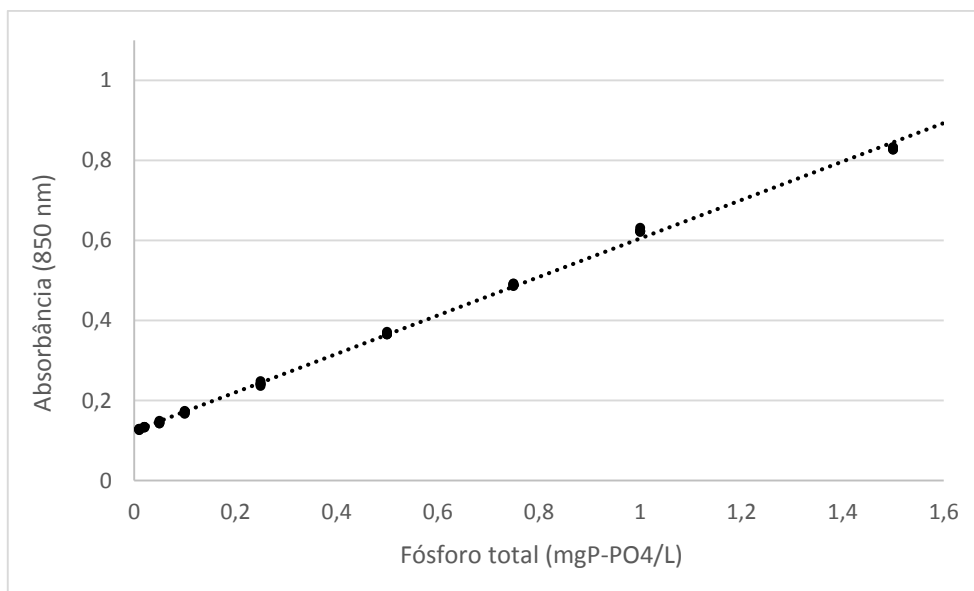


Técnico responsável