

# CERTIFICADO DE ANÁLISE



**Teste em cubetas:** Detergentes aniônicos Cód. UP151  
**Faixa de leitura:** 0,2 – 2,0 mgLAS/L  
**Lote:** 151021  
**Validade:** 12/2019

**Técnico responsável pela calibração:** Joana Sartoretto Leão

**Equipamento utilizado para calibração:** espectrofotômetro da marca Hach, modelo DR3900

**Comprimento de onda:** 653 nm


**Substância padrão:** Dodecil sulfato de sódio


**Fórmula:**  $C = a + b \cdot A$

**a = - 0,13858**

**b = 1,64846**

**R<sup>2</sup> = 0,9978**

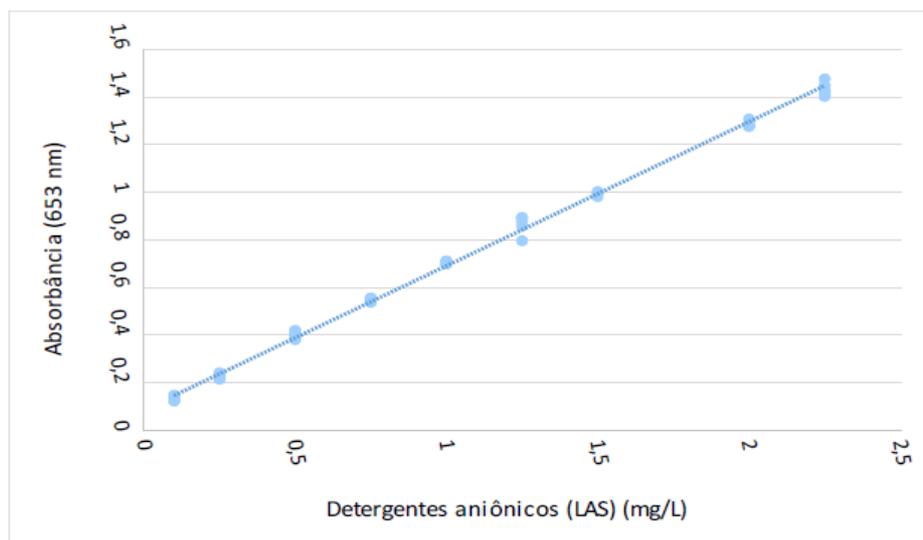

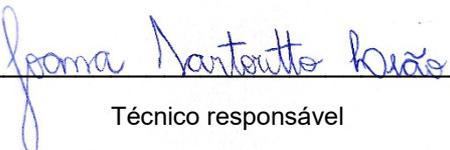  
Técnico responsável