

CERTIFICADO DE ANÁLISE



Teste em cubetas: DQO Cód. UP112
Faixa de leitura: 100 – 2000 mgO₂/L
Lote: 112027
Validade: 10/2017

Data da calibração: 25/11/2014

Técnico responsável: Mayara Evelyn Vendramin

Equipamento: DR3900

Comprimento de onda: 605 nm

Substância padrão: hidrogenoftalato de potássio

Variação permitida: ±10 % para os espectrofotômetros Hach, modelos DR2800, DR3900, DR 5000 e DR 6000


Calibração espectrofotômetros Hach: $C = a + b \cdot A$

$a = -169,3$

$b = 2660,6$

$R^2 = 0,9954$

$R = 0,9977$

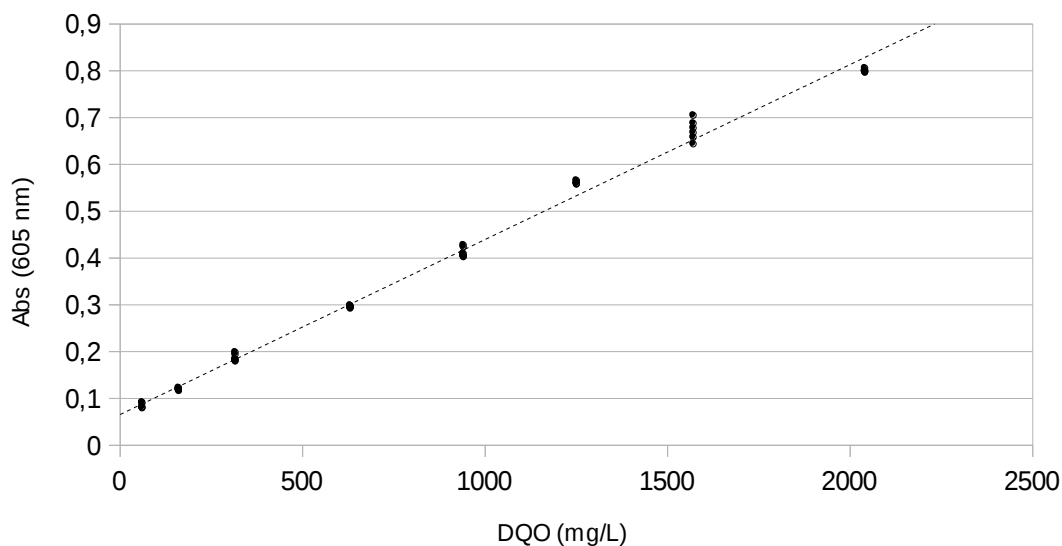

Mayara Evelyn Vendramin

Técnico responsável